
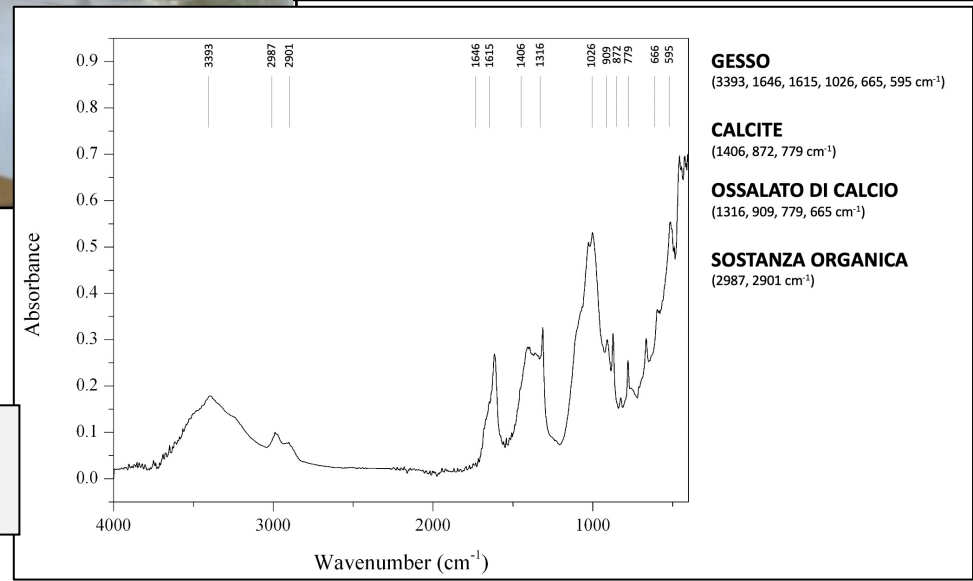


LABORATORIO spettrometria infrarossa

Resp. Scientifico: Prof. Silvio G. Rotolo (silvio.rotolo@unipa.it). Ubicazione: Via Archirafi 26, 5° piano).

- **banco IR (Bruker Tensor 27):** analisi qualitativa (spettri FT-IR) di pigmenti, leganti e materiali impiegati nel restauro.
- **microscopio IR (Hyperion 2000):** determinazione di H_2O e CO_2 in minerali e inclusioni vetrose, vetri vulcanici.

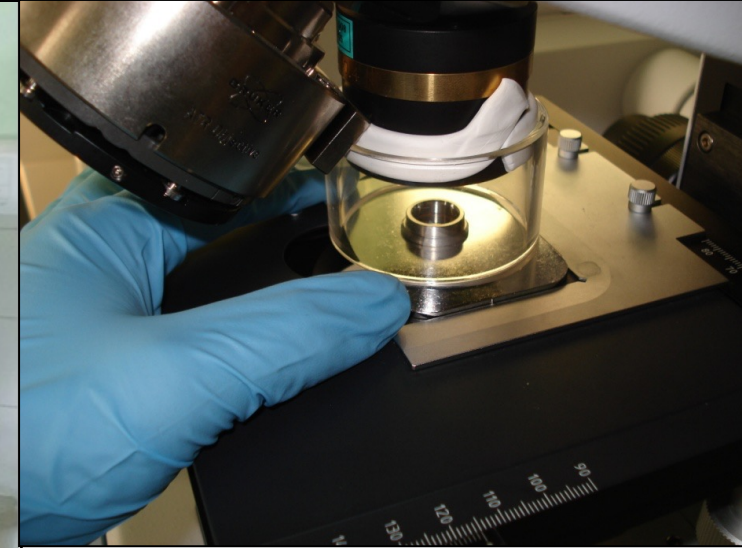

Spettro FT-IR di uno stucco
medievale con finitura dipinta